




Исследовательские стереомикроскопы SMZ25/18

Исследовательские стереомикроскопы

# SMZ25 SMZ18

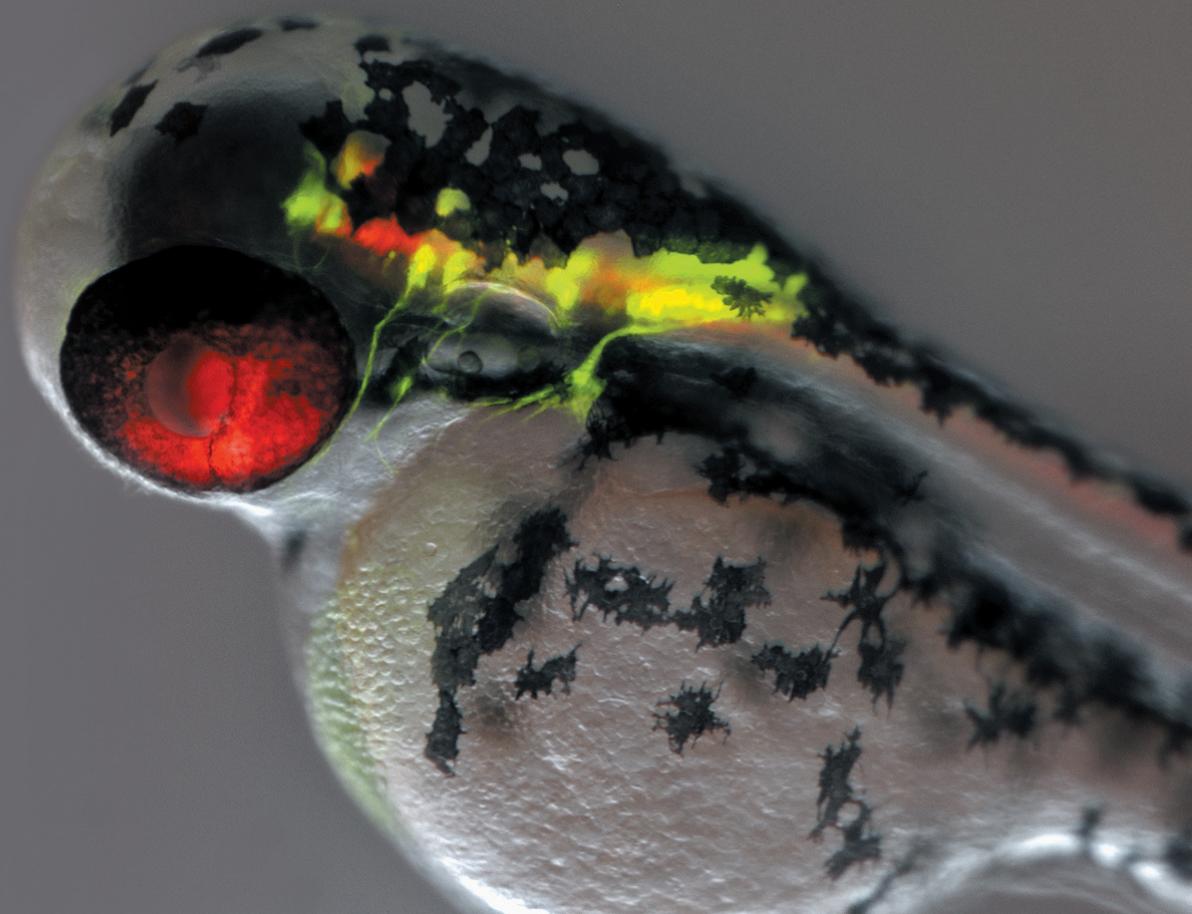

Визуализация нейронов живой Zebrafish, экспрессирующей GFP и RFP, полученная с использованием нового исследовательского стереомикроскопа Nikon SMZ25 (флуоресценция и изображение при косом освещении). Предоставлено Джо Фетчо (Joe Fecho), Ph.D., Корнельский университет.

# Откройте для себя новую эволюцию Гигантский шаг вперед в стереомикроскопии

Традиционные границы между научными областями, такими как молекулярная биология и биология развития, быстро исчезают, когда исследователи начинают использовать результаты полученные на молекулярном уровне в ходе клеточных, тканевых исследований и исследований организмов. Области, в том числе молекулярная биология, клеточная биология, нейробиология, эмбриология, биология развития и системная биология, испытывают все большие потребности в системах визуализации, которые охватывают пространственные масштабы от одной клетки до целого организма. Понимая эти требования, компания Nikon разработала новый стереомикроскоп, который имеет более высокий коэффициент трансфокации 25:1, высокое разрешение и исключительную способность передачи флуоресценции. Этот новейший микроскоп в серии SMZ представляет собой веху в эволюции стереомикроскопов, а также гарантирует, что ваше исследование будет выведено на следующий уровень.

## Самый широкий диапазон трансфокации и самое высокое разрешение в серии SMZ

- Первый стереомикроскоп\*, который имеет диапазон трансфокации 25:1 (SMZ25)
- Числовая апертура (NA) до 0,156 \*, с использованием объектива SHR Apo 1x и системой трансфокации SMZ25 \* По состоянию на май 2013 года

## Яркие и высококонтрастные флуоресцентные изображения


- Оптическая система «fly-eye» обеспечивает равномерное и однородное освещение препарата по всему полю зрения даже при самом низком увеличении
- Прорыв в оптическом дизайне ведет к значительному повышению соотношения сигнал-шум и получению кристально чистых флуоресцентных изображений

## Автоматизация и цифровые изображения

- Моторизованная фокусировка и изменение увеличения (SMZ25)
- Программное обеспечение NIS-Elements позволяет использовать несколько методов визуализации, обработки и анализа изображения, включая захват изображений по оси z (z-стэк), покадровую съемку, а также получение EDF-изображений

## Простота в использовании

- Удобный пульт дистанционного управления (SMZ25)
- Легкое в эксплуатации тонкое основание LED DIA с возможностью косого освещения
- Широкий выбор осветителей и аксессуаров позволяет внедрять различные методы наблюдения

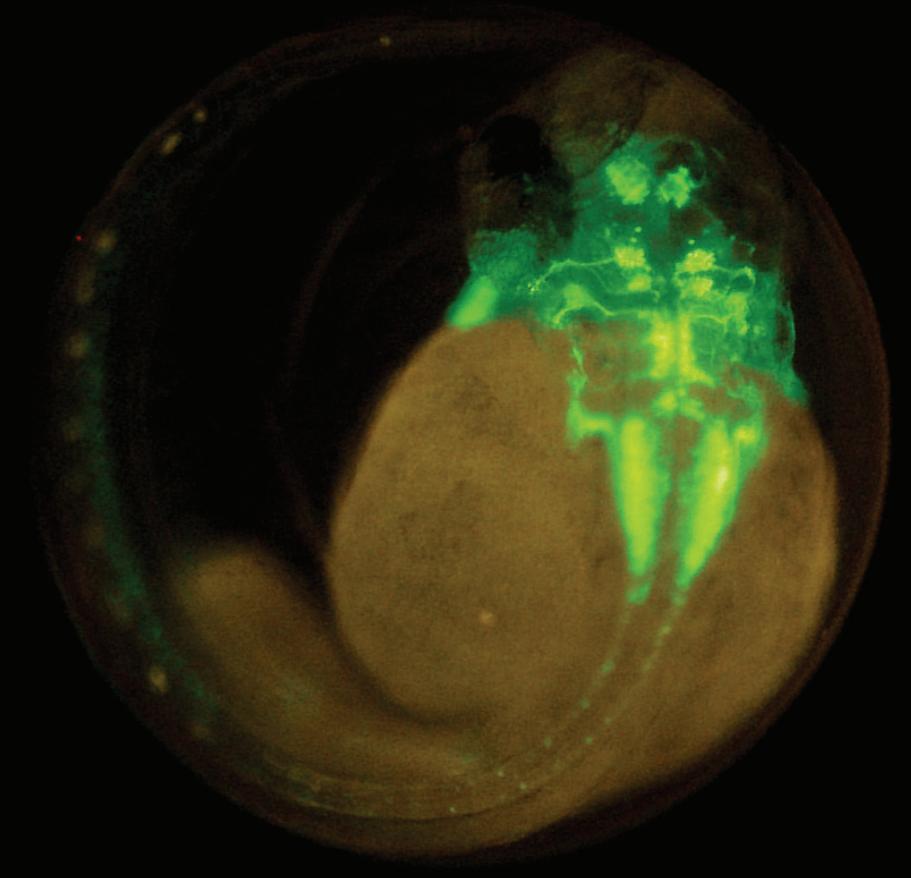

2-дневный трансгенный эмбрион Zebrafish, Tg (isl1-GFP)  
(с использованием SHR Plan Apo 1x при коэффициенте трансфокации 6x, SMZ25)  
Изображение предоставлено Хисая Какинумой (Hisaya Kakinuma), Ph.D.,  
Лаборатория генной регуляции развития,  
Научная группа развития мозга,  
Институт мозга РИКЕН (RIKEN)

## SMZ25



Модель с моторизированным трансфокатором с самым высоким коэффициентом трансфокации и разрешением в серии SMZ

## SMZ18



Модель с ручным управлением, усовершенствованными оптическими характеристиками и невероятно яркой флуоресценцией при экономичной стоимости

	Моторизированная трансфокация	Ручная настройка трансфокации
Методы наблюдения	BF/DF/FL/простая поляризация	BF/DF/FL/простая поляризация
Коэффициент трансфокации	25:1	18:1
Диапазон увеличения	0,63x ~ 15,75x	0,75x ~ 13,5x
Максимальное увеличение	315x <sup>1</sup>	270x <sup>1</sup>
Максимальное поле зрения (FOV)	ø70мм <sup>2</sup>	ø59мм <sup>2</sup>
Максимальная числовая апертура объектива	0,312 <sup>3</sup>	0,3 <sup>3</sup>

<sup>1</sup>: С использованием SHR Plan Apo 2x/C-W 10xB


<sup>2</sup>: С использованием SHR Plan Apo 0,5x/C-W 10xB

<sup>3</sup>: С использованием SHR Plan Apo 2x

# Самый большой в мире диапазон трансфокации и невероятное разрешение


## Коэффициент трансфокации 25:1 SMZ25

Инновационная оптическая система, известная как «Perfect Zoom Optics», обеспечивает первый в мире коэффициент трансфокации 25:1 (диапазон увеличения: 0,63x – 15,75x\*; \*по состоянию на май 2013 года). Даже с объективом 1x SMZ25 позволяет получить изображение всей чашке Петри диаметром 35 мм и одновременно обеспечивает распознавание микроскопических деталей.

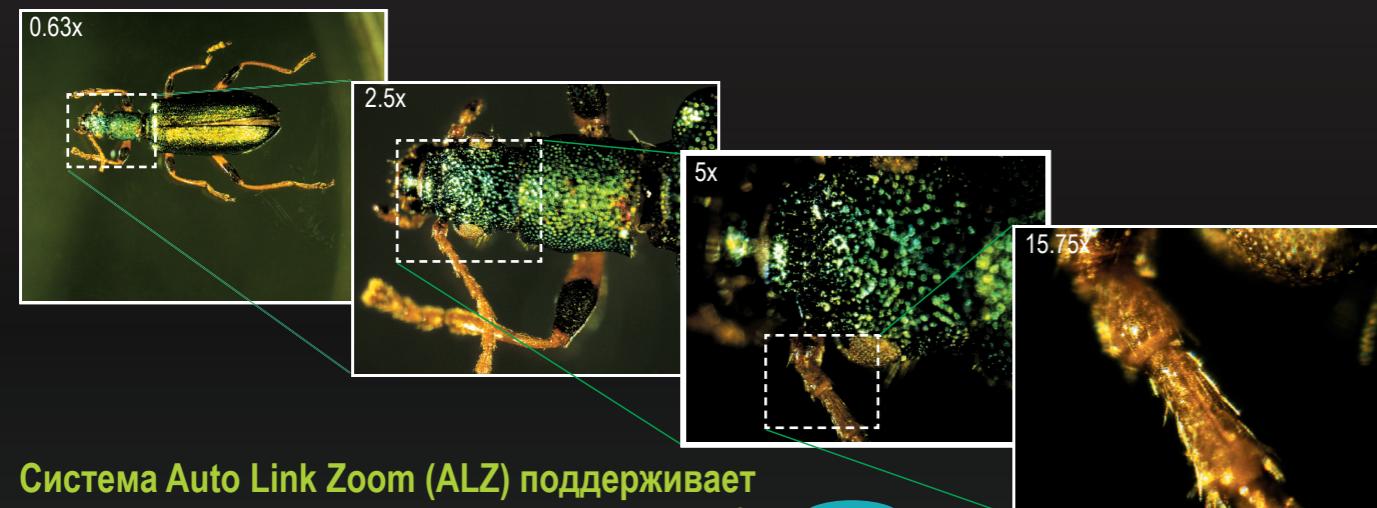

## Система Auto Link Zoom (ALZ) поддерживает плавный просмотр при различном масштабе SMZ25

Система ALZ автоматически настраивает коэффициент трансфокации для поддержания того же поля зрения при смене объективов. Эта функция позволяет осуществлять плавное переключение между изображением целого организма при низком увеличении и подробным изображением при большом увеличении.

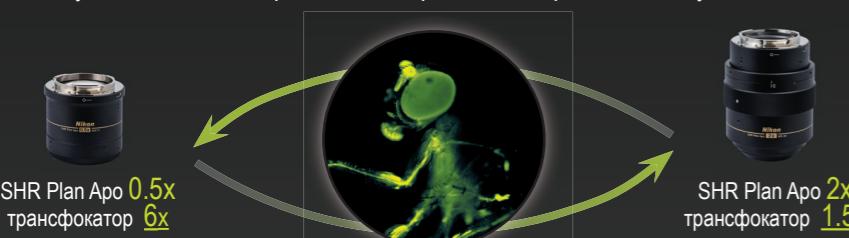


### Поддерживает FOV при общем увеличении 3x

Взрослая Drosophila, экспрессия мембраносвязанного GFP вызванная геном Gal4, в периферийных клетках (с SMZ25)  
Изображение предоставлено Хокуто Казама (Hokuto Kazama), Ph.D. Лаборатория циркуляционных механизмов сенсорного восприятия РИКЕН (RIKEN)

## Nikon предлагает самый высокий коэффициент трансфокации, благодаря системе «Perfect Zoom Optics» SMZ25 SMZ25

Прорыв в дизайне стереоскопов, Perfect Zoom Optics динамически изменяет расстояние между двумя оптическими осями при изменении коэффициента трансфокации. Это изменение расстояния между оптическими осями позволяет максимально увеличить количество света попадающего в оптическую систему при разном увеличении. Как результат - большой диапазон увеличения, высокое разрешение для обоих оптических каналов и минимальные aberrации во всем диапазоне увеличения. Кроме того, этот прорыв в области оптического дизайна позволяет разместить все эти желательные функции в компактном корпусе микроскопа, обеспечивая в результате эргономичный дизайн прибора.

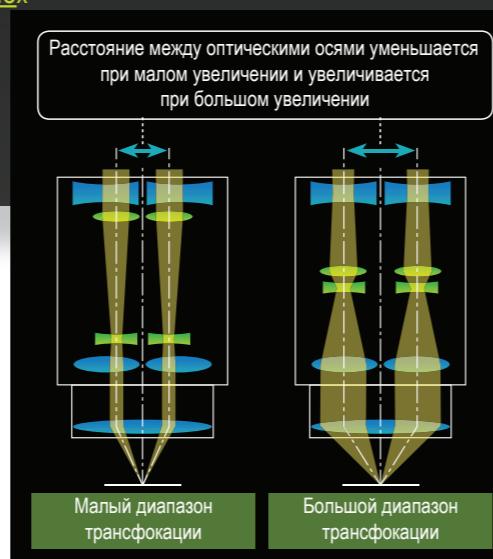


Более высокое значение числовой апертуры для обоих каналов в сочетании с превосходным коэффициентом трансфокации обеспечивает плавный просмотр на макро-и микроуровне.

## Превосходное разрешение, никогда ранее не достичимое в стереомикроскопе


Серия Nikon SMZ25 обеспечивает превосходную числовую апертуру 0,156 для объективов SHR Plan Apo 1x и 0,312 для SHR Plan Apo 2x.

Традиционно исследователи должны были переключаться на более высокое увеличение для просмотра микроскопических деталей после использования стереомикроскопа для просмотра или манипуляций с макроскопическими структурами. Микроскопы SMZ25/18 компании Nikon устранили эту необходимость, предоставив возможность визуализации как макро-, так и микроскопических структур. Например, объектив SHR Plan Apo 2x позволяет визуализировать структуры размером в несколько микрон, что когда-то считалось невозможным при использовании стереомикроскопа. Апохроматическая коррекция сохраняется в объективе и оптической системе трансфокатора, практически полностью устранив цветовые aberrации.

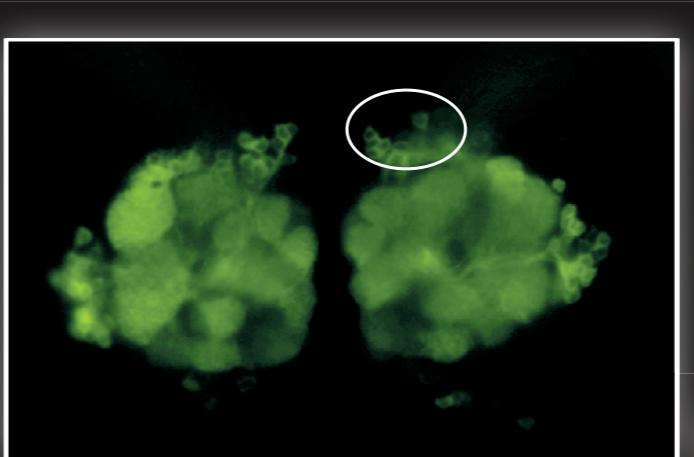

Отдельные обонятельные нервные клетки Drosophila экспрессирующей GFP-мембранный маркер четко различимы как черные тела, окруженные флуоресцентными мембранами (см. обведенные области). Это изображение демонстрирует невероятно высокое разрешение SMZ25, так как размер обонятельных клеток, как правило, в диаметре около 5 мкм.

Мозг Drosophila, GFP-  
(с использованием SHR Plan Apo 2x при трансфокации 15,75x с SMZ25)  
Изображение предоставлено Хокуто Казама (Hokuto Kazama), Ph.D.  
Лаборатория циркуляционных механизмов сенсорного восприятия РИКЕН (RIKEN)

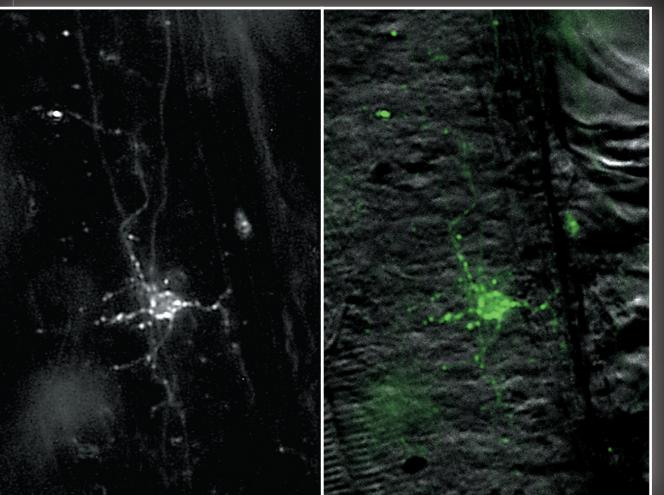

Отдельный двигательный нейрон экспрессирующий кластеры рецепторов GFP-глицина (в виде отдельных точек вдоль тела клетки и процессов) у живых Zebrafish

Zebrafish (GFP и косое освещение)  
(с использованием SHR Plan Apo 2x при трансфокации 15,75x с SMZ25)  
Изображение предоставлено Джо Фетчо (Joe Fetcho), Ph.D.,  
Корнельский университет

## Новые высокоеффективные объективы SMZ25 SMZ18

Компания Nikon разработала серию объективов SHR Plan Apo, которая предлагает высокое разрешение 1100LP/mm (получено с использованием SHR Plan Apo 2x при максимальном увеличении). Объективы с более низким увеличением 0,5x, 1x или 1,6x дают светлое поле зрения и яркое изображение с реалистичными цветами.

Сравнение разрешения и хроматической aberrации согласно таблице разрешения	
SMZ25	Обычная модель
500	500
1100	1100
550	550
1050	1050
600	600
1000	1000
950	950
600	600
950	950


С камерой DS-Qi1, SHR Plan Apo 2x, максимальным увеличением и CFP-HQ EX 420-445 нм.

С камерой DS-Ri1, SHR Plan Apo 1,6x и максимальным увеличением

# Яркие и высококонтрастные флуоресцентные изображения

## Улучшенная яркость и равномерная подсветка при малом увеличении

Даже при малом увеличении микроскопы SMZ25 позволяют получить изображение всей 35 мм чашки Петри с одинаковой яркостью по всему полю зрения\*, что делает эти микроскопы идеальными для скрининга в режиме реального времени модельных организмов нематод *C. elegans*, дрозофил, Zebrafish и мышей для определения и отбора мутантов. Микроскопы серии SMZ25 также позволяют делать яркие снимки даже при низком уровне возбуждающего света, благодаря чему удается избежать фото-обесцвечивания и фото-токсичности, вредных для живых клеток и организмов. \*При использовании SMZ25/SHR Plan Apo 1x

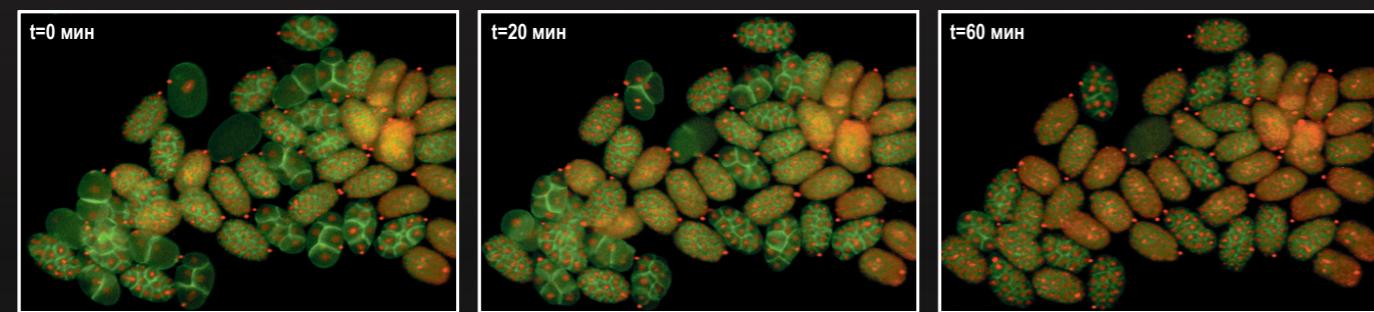

Изображения с временным разрешением развивающихся эмбрионов *C. elegans* экспрессирующих RFP-гистонов и GFP-мембранных маркеров позволяют исследователям определить мутантные организмы для цитокинеза до отбора для последующего изучения.


Эмбрионы *C. elegans* (GFP и RFP; диаметр каждого овоида - 030 $\mu$ m) (использован SHR Plan Apo 2x с увеличением 8x и SMZ25)  
Изображение предоставлено Джули С. Кэнман (Julie C. Canman), Ph.D., Колумбийский университет.

Эмбрион мыши в возрасте 12,5 дней, красное: зародыш (с использованием SHR Plan Apo 0.5x при увеличении 1,30x с SMZ18)  
Изображение предоставлено Кадзуо Ямагата (Kazuo Yamagata), Ph.D.  
Центр генетического анализа биологических реакций, Научно-исследовательский институт микробных заболеваний, Университет Осаки



## Линзы fly eye обеспечивают равномерную яркость по всему полю зрения

Серия SMZ25 является первым в мире стереомикроскопом, использующим линзы fly eye на оборудовании для эпи-флуоресценции. Эта инновационная конструкция обеспечивает яркое и равномерное освещение даже при небольшом увеличении, давая в результате бескомпромиссную равномерность яркости по всему полю зрения.

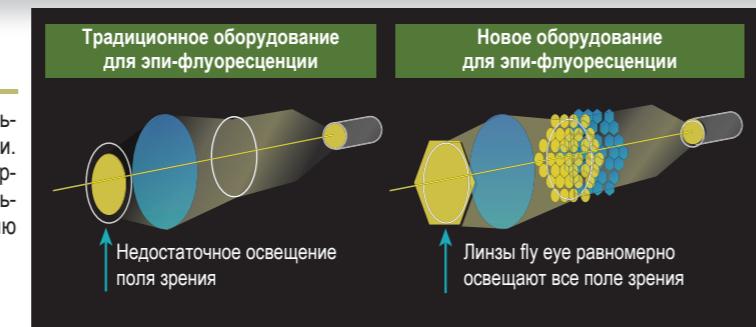




Новое оборудование для эпи-флуоресценции дает возможность получить четкие флуоресцентные изображения.

## Более высокое соотношение сигнал/шум и кристально чистые флуоресцентные изображения благодаря улучшенной оптической системе


Новая оптическая система Nikon обеспечивает значительное повышение соотношения сигнал/шум даже при большом увеличении. Это соотношение сигнал /шум позволяет захватить изображение делящихся клеток, что трудно осуществить с помощью обычных стереомикроскопов, и флуоресценцию образов возбужденных слабым излучением.

Позволяет наблюдать веретено при делении клеток


Оплодотворенное яйцо мыши, зеленое: веретено (EGFP- $\alpha$ -тубулин), красное: ядро (Histon H2B-mRFP1) (с использованием SHR Plan Apo 1x при увеличении 13,5x с SMZ25)  
Изображение предоставлено Кадзуо Ямагата (Kazuo Yamagata), Ph.D.  
Центр генетического анализа биологических реакций, Научно-исследовательский институт микробных заболеваний, Университет Осаки

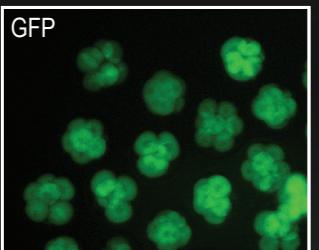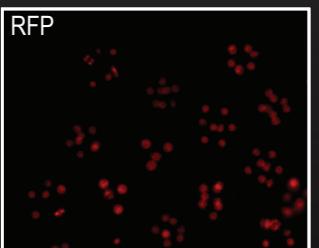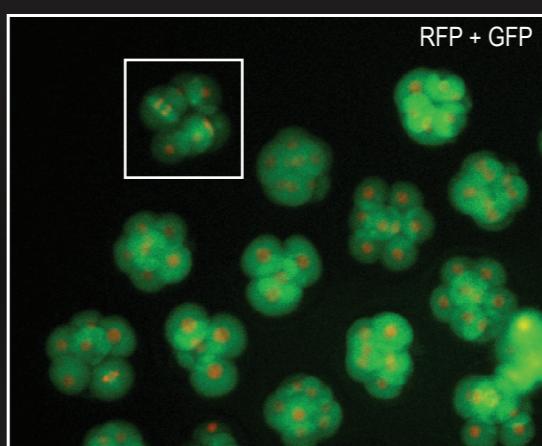

Одиночные флуоресцентные нейроны могут быть визуализированы в живых тканях *C. elegans*

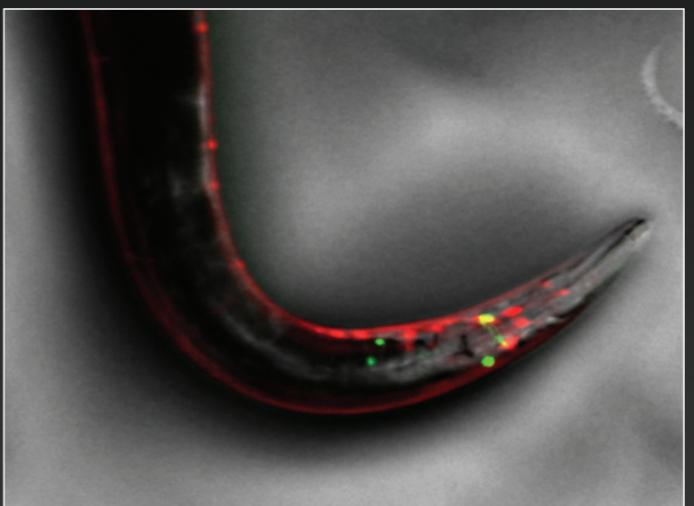


Флуоресценция и изображение при косом освещении живых *C. elegans* нейронов экспрессирующих GFP- и RFP (с использованием SHR Plan Apo 2x при увеличении 3x с SMZ25)  
Изображение предоставлено Джулией С. Кэнман (Julie C. Canman), Ph.D., Колумбийский университет

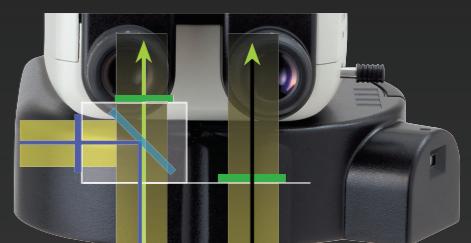

## Система трансфокации с усовершенствованными оптическими характеристиками

Nikon удалось повысить сигнал и снизить шум во флуоресцентных изображениях, используя короткую длину волн и высокое пропускание объектива Fluor. В сочетании с новым оборудованием для эпи-флуоресценции SMZ18/25 более успешно детектирует возбуждающий свет чем обычные люминесцентные стереомикроскопы.

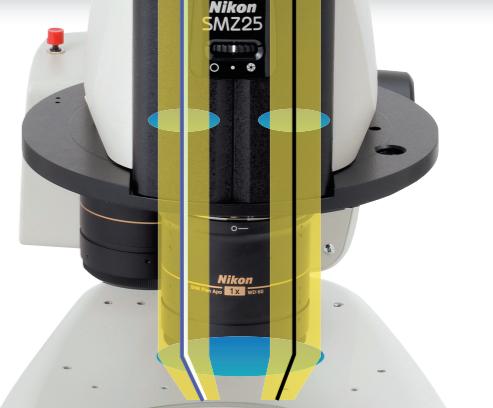

# Автоматизация и цифровое изображение

Широкий спектр возможностей цифровой визуализации с цифровыми камерами серии Digital Sight и программным обеспечением NIS-Elements.

## Легкий в использовании пульт дистанционного управления

Совершенно новый пульт дистанционного управления обеспечивает легкий доступ к регулировки увеличения и фокуса как правой, так и левой рукой.

Пульт дистанционного управления содержит ЖК-монитор с регулируемой подсветкой, который дает информацию о коэффициенте увеличения, объективе, кубе флуоресцентных фильтров и яркости LED осветителя. Подсветка ЖК-монитора может быть отключена для устранения помех при низкой освещенности изображений.

Кроме пульта дистанционного управления, микроскопом можно также управлять с помощью компьютера.




## Легкий и быстрый доступ к нужной информации

Легко получить необходимую информацию о Z-положении фокусировочного привода, коэффициенте увеличения, объективе, фильтровом кубе и яркости LED осветителя с использованием цифровой камеры серии Digital Sight и программного обеспечения NIS-Elements или контроллера серии Digital Sight DS-L3 вместе с микроскопом.

## Осьное изображение для цифровой визуализации

Легкое переключение между стереоположением (стереоскопическим изображением) и моноположением (осевым изображением) при использовании револьвера P2-RNi2 Intelligent Nosepiece простым смещением объектива. Цифровые изображения могут быть легко получены с помощью моноположения.

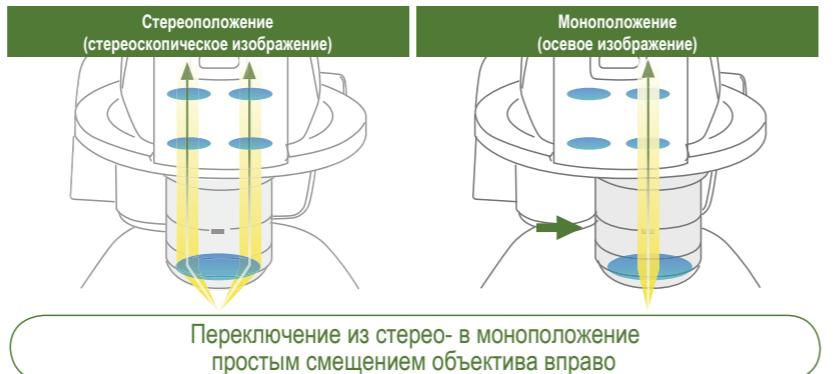


Программное обеспечение  
NIS-Elements  
Одно программное обеспечение для всех систем: NIS-Elements, являющееся флагманом компании Nikon, программное обеспечение обработки изображений для разных платформ теперь можно использовать со стереомикроскопами Nikon SMZ25 и SMZ18. NIS-Elements дает широкий спектр современных возможностей обработки цифровых изображений с ПК.

### Многоканальный (многоцветный)


Несколько каналов флуоресценции может быть использовано в сочетании с другими методами визуализации, такими как косое освещение или светлое поле. Отдельные клетки живого эмбриона дрозофилы в экспрессии GPF и mCherry (с использованием SHR Plan Apo 2x при увеличении 8x с SMZ25)

Изображение предоставлено Максом В. Стальпером (Max V. Staller), Ph.D., Клариссой Скоулз (Clarissa S choles), и Анжелой ДеПас (Angela D ePace), Ph.D., Гарвардская медицинская школа

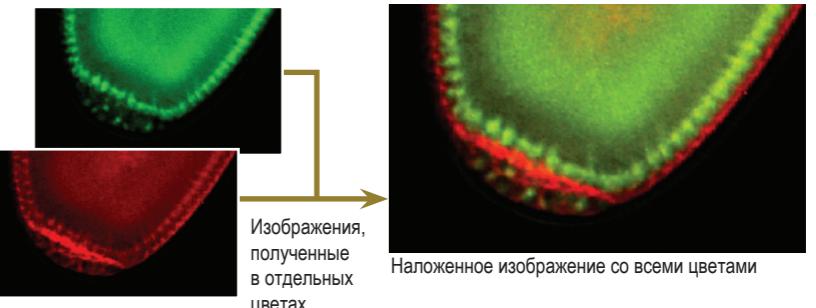

### Покадровая съемка

Легко настраиваемая покадровая съемка с NIS-Elements.

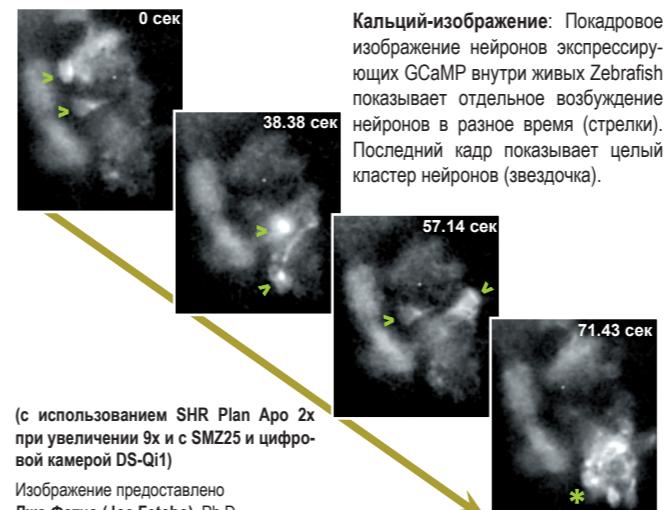


(с использованием SHR Plan Apo 2x при увеличении 9x с SMZ25 и цифровой камеры DS-Qi1)

Изображение предоставлено  
Джо Фетчо (Joe Fetscho), Ph.D.,  
Корнельский университет

Кальций-изображение: Покадровое изображение нейронов экспрессирующих GCaMP внутри живых Zebrafish показывает отдельное возбуждение нейронов в разное время (斯特релки). Последний кадр показывает целый кластер нейронов (звездочка).

### Большая глубина резкости (EDF)

Захват нескольких изображений с высоким разрешением на различных глубинах резкости для создания единого изображения с увеличенной глубиной резкости или квази-3D-изображения.

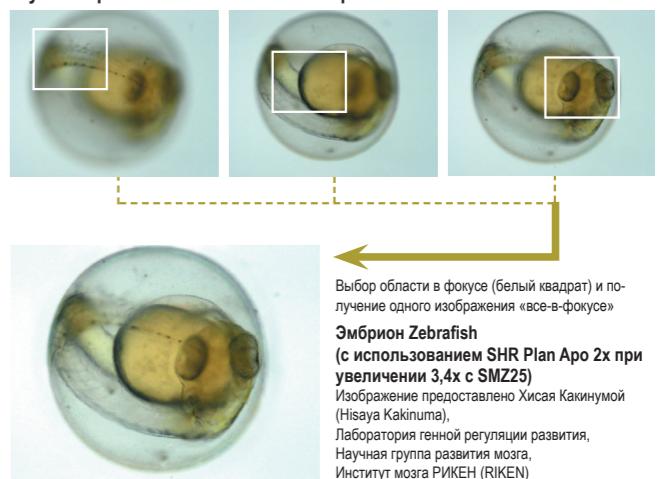

DS-L3 представляет собой простой в применении монитор с высокой четкостью изображения и большой сенсорной панелью, который может быть использован для быстрого захвата изображений без использования компьютера или монитора.

### Контроллер Digital Sight DS-L3

### Слежение за масштабом

Масштабная линейка автоматически настраивается при изменении увеличения

### Режим съемки

Оптимальные параметры изображения для каждого типа образца и метода наблюдения можно легко установить с помощью иконок



## Выберите идеальную камеру для конкретных целей

Цифровая камера с охлаждением и ультравысокой четкостью

### DS-Ri1

- Высокое разрешение 12,7 мегапикселей
- Отличная цветопередача
- На 10°C ниже температуры окружающей среды



Цифровая камера с высокой четкостью

### DS-Fi2

- Высокое разрешение 5,0 мегапикс.
- Высокая скорость съемки
- Подходит для широкого диапазона задач



Цифровая монохромная камера с охлаждением и высокой чувствительностью

### DS-Q.i1

- Высокая чувствительность и низкий уровень шума
- Высокие количественные возможности
- Охлаждаемая 1,5 мегапиксельная CCD матрица



1.5 мегапикселей

Охлаждение

\*Для получения дополнительной информации см. каталоги серии Digital Sight

## Большой выбор аксессуаров

### Базовый блок

Nikon упростил использование оборудования путем перемещения элементов управления на переднюю часть основания, в том числе регулировку яркости и выключатель.

#### Основание Fiber DIA base

Основание Fiber DIA base оснащено конденсорными линзами, которые можно переключать между низким и высоким увеличением. Кроме того, система освещения Oblique Coherent Contrast (OCC, метод косого освещения) позволяет достичь высококонтрастной освещенности.



1 Основание для оптоволоконного диаскопического освещения P2-DBF



2 Основание для диаскопического освещения P2-DBL LED



3 Плоское основание P2-PB



Обычное Основание

Тонкое основание

### Примеры использования

#### Осветитель OCC



Новое основание LED DIA Base со встроенным осветителем OCC выделяет минимум тепла, потребляет мало электроэнергии и имеет длительный срок службы. Осветитель может повысить контрастность неровных поверхностей, например, эмбрионов.



Автоматическая система термоконтроля столика микроскопа

**Термопластина MATS**  
(Производитель: Tokai Hit Co., Ltd.)

Плоская поверхность пластины обеспечивает удобство управления манипулятором и работы с образцом.

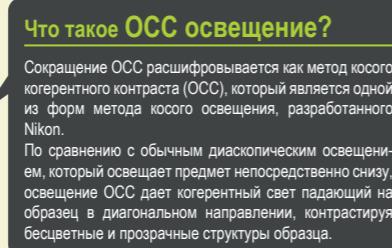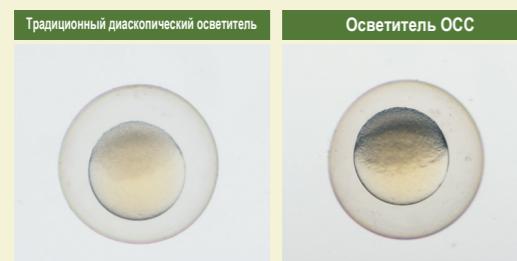

Сокращение OCC расшифровывается как метод косого когерентного контраста (OCC), который является одной из форм метода косого освещения, разработанного Nikon. По сравнению с обычным диаскопическим освещением, который освещает предмет непосредственно снизу, освещение OCC дает когерентный свет падающий на образец в диагональном направлении, контрастируя бесцветные и прозрачные структуры образца.

Эмбрион Zebrafish (с использованием SHR Plan Apo 1x при увеличении 5x с SMZ18) Изображение предоставлено Юничи Накай, Ph.D. Университет Сайтама, Институт мозга.

### Фокусирующий привод

Фокусирующий привод объединен с основанием. Выберите ручной или моторизованный фокусирующий привод.



1 Моторизованный фокусирующий привод P2-MFU

2 Фокусирующий привод P2-FU

### Штатив / фокусирующее крепление SMZ18

Объедините штатив с фокусирующим креплением для просмотра и захвата изображений с отраженным освещением.



1 Фокусирующее крепление P2-FMDN  
2 Плоский штатив P-PS32

### Серия объективов SHR Plan Apo

Серия объективов SHR Plan Apo обладает более высокой числовой апертурой, более широким полем зрения, превосходной плоскостью и коррекцией аберраций.

Эти объективы могут легко переключаться, т.к они имеют одинаковое парфокальное расстояние. Новый дизайн байонетного крепления позволяет безопасно и легко снимать объективы.



1 P2-SHR Plan Apo 0,5x  
2 P2-SHR Plan Apo 1,6x  
3 P2-SHR Plan Apo 1x  
4 P2-SHR Plan Apo 2x

		SHR Plan Apo 0,5x	SHR Plan Apo 1x	SHR Plan Apo 1,6x	SHR Plan Apo 2x
Максимальное значение числовой апертуры	SMZ25	0,078	0,156	0,25	0,321
SMZ18	0,075	0,15	0,24	0,3	
Рабочее расстояние	71 мм	60 мм	30 мм	20 мм	
Кольцо коррекции	-	-	-	3 мм воды	
Длина волны					380-700 нм

### Тубусы

Выберите один из двух типов наклоняемых триподиальных тубусов и один тип триподиального тубуса с низким расположением окуляров. Все тубусы имеют порт для установки цифровой камеры серии Digital Sight.



1 Наклоняемый триподиальный тубус P2-TERG100 (окуляр: порт 100:0/0:100)  
2 Наклоняемый триподиальный тубус P2-TERG50 (окуляр: порт 100:0/50:50)  
3 P2-TL100 триподиальный тубус L (окуляр: порт 100:0/0:100)

### Револьвер / адаптер фокусирующего крепления

Существует возможность установки револьвера или адаптера фокусирующего крепления в целях расширения исследований при изменении диапазона увеличений.



1 Револьвер P2-RNI2 Intelligent Nosepiece  
2 Адаптер фокусирующего крепления P2-FM

### Предметный столик

XY ход предметного столика составляет 6x4 \* дюйма (150 мм x 100 мм). Столик может быть присоединен к любому из оснований, что делает эффективным захват больших изображений при использовании в комбинации с программным обеспечением обработки изображений NIS-Elements. Имеется также сдвигающийся и наклоняемый столик.

\* Ограниченный ход по оси Y с основаниями 32 мм



Предметный столик P-SXY64 XY

### Контроллер

Nikon предлагает пульт дистанционного управления, который можно использовать для управления микроскопом и ручного захвата изображений. Также предлагается педаль, которая позволяет пользователю работать с микроскопом и захватывать изображения с помощью ноги, освобождая руки для манипуляций с образцом.



1 Пульт дистанционного управления P2-RC  
2 Педальный переключатель AZ-FSW

## Большой выбор аксессуаров

### Оборудование для эпи-флуоресценции

#### Моторизованное оборудование для эпи-флуоресценции

Флуоресцентной турелью можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или программного обеспечения обработки изображений NIS-Elements.



- 1 Моторизованное эпи-флуоресцентное оборудование P2-EFLM
- 2 Защитный экран (поставляется с флуоресцентным оборудованием)
- 3 Фильтровый куб P2-EFL (GFP-B/GFP-L/RFP)
- 4 Фильтровый куб P2-EFLBF (светлое поле, с λ/4 пластины)
- 5 Блок управления P2-CTLA
- 6 Пульт дистанционного управления P2-RC



Комбинации с SMZ25

#### Оборудование для эпи-флуоресценции с ручным управлением

Легкая в ручном управлении модель для недавно разработанного высокопроизводительного оборудования Nikon для флуоресценции.



- 1 Оборудование для эпи-флуоресценции P2-EFLI
- 2 Защитный экран (поставляется с флуоресцентным оборудованием)
- 3 Фильтровый куб P2-EFL (GFP-B/GFP-L/RFP)
- 4 Фильтровый куб P2-EFLBF (светлое поле, с λ/4 пластины)
- 5 Блок управления P2-CTLB



Комбинации с SMZ25

### Оптоволоконный осветитель

#### Двухплечий оптоволоконный осветитель

Направление и угол освещения могут быть изменены в соответствии с положением образца путем настройки двух плеч осветителя. Положение оптоволоконного держателя можно изменить для достижения оптимального освещения образца.

- 1 Гибкий двойной световод C-FDF
- 2 Держатель световода
- 3 Оптоволоконный осветитель C-FIDH
- 4 Источник света для оптоволоконного осветителя C-FLED2 LED



Комбинации с SMZ18

#### Кольцевой оптоволоконный осветитель

Этот набор кольцевого оптоволоконного осветителя оснащен блоком эпикопического освещения (может быть использован с объективами 1x и 0,5x).

- 1 Кольцевой оптоволоконный осветитель P2-FIR
- 2 Источник света для оптоволоконного осветителя C-FLED2 LED



Комбинации с SMZ18

### Коаксиальный осветитель

Коаксиальный осветитель делает возможным детектирование света отраженного от поверхности образца, идеально подходит для получения изображений толстых образцов с небольшим затенением.

- 1 Коаксиальный эпикопический осветитель P2-CI
- 2 Источник света для оптоволоконного осветителя C-FLED2 LED



Комбинации с SMZ18

### Кольцевой светодиодный осветитель

Кольцевой светодиодный осветитель оснащен светодиодами высокой интенсивности и большим сроком службы.

- 1 Кольцевой светодиодный осветитель P2-FIRL LED



Комбинации с SMZ18

### Аксессуары для наблюдения в темном поле

Темнопольный просмотр возможен путем простого присоединения блока темного поля к основанию.





- 1 Блок для темного поля P-DF LED
- 2 Экран




## Спецификации

	SMZ25	SMZ18
Система трансфокации		
Оптическая система	Параллельная система, ахроматическая оптическая система	С ручной регулировкой
Увеличение	Моторизированное	С ручной регулировкой
Коэффициент трансфокации:	25:1	18:1
Диапазон трансфокации:	0,63-15,75x	0,75-13,5x
Апертурная диафрагма	Встроенная	Встроенная
Объективы, NA, WD (мм)		
• P2-SHR Plan Apo 2x	0,312, 20 (с корректирующим кольцом для воды от 0 до 3 мм в глубину)	0,3, 20 (с корректирующим кольцом для воды от 0 до 3 мм в глубину)
• P2-SHR Plan Apo 1,6x	0,25, 30	0,24, 30
• P2-SHR Plan Apo 1x	0,156, 60	0,15, 60
• P2-SHR Plan Apo 0,5x	0,078, 71	0,075, 71,
Общее увеличение (с использованием окуляров 10x)	3,15-315x (в зависимости от используемого объектива)	3,75-270x (в зависимости от используемого объектива)
Окуляры (F.O.V. мм)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C-W 10xB (22)</li> <li>• CW 15x (16)</li> <li>• CW 20x (12,5)</li> <li>• C-W 30x(7)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2-TERG 100 Тринокулярный наклоняемый тубус (100/0 : 0/100)</li> <li>• P2-TERG 50 Тринокулярный наклоняемый тубус (100/0 : 50/50) Угол наклона: 0°~30°</li> <li>• P2-TERG 100 Тринокулярный тубус L (100/0 : 0/100) Угол наклона: 15°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2-FU ручное устройство (до 97 мм/вниз 5 мм)</li> </ul>
Фокусирующий привод (ход от парфокальной точки объектива)	P2-MFU моторизованное фокусирующее устройство (до 96 мм/вниз 4 мм)	P2-FU ручное устройство (до 97 мм/вниз 5 мм)
Адаптер фокусирующего крепления /Револьвер	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2-FM Адаптер фокусирующего крепления</li> <li>• P2-RNI2 кодированный револьвер (можно установить два объектива)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2-RNI2 кодированный револьвер (можно установить два объектива)</li> <li>• P2-FMDM Фокусирующее крепление (65 мм) (для простого штатива P-PS32)</li> </ul>
Основания/Штатив	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плоское основание P2-PB Plain Base</li> <li>• Основание для диаскопического освещения P2-DBL LED Diascopic Illumination Base (встроенный светильник OCC)</li> <li>• Основание для оптоволоконного диаскопического освещения P2-DBF Fiber Diascopic Illumination Base</li> <li>• Плоский штатив P-PS32 (только для SMZ18)</li> </ul>	
Предметные столики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предметный столик P-SXY64</li> <li>• Предметный столик C-SSL, с перемещением по двум осям</li> <li>• Наклоняемый предметный столик C-TRS</li> </ul>	
Оборудование для эпифлуоресценции	4 фильтровых куба, встроенные линзы с оптикой Fly eye	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Моторизированное оборудование для эпифлуоресценции P2-EFLM</li> <li>• Моторизированное оборудование для эпифлуоресценции P2-EFLI</li> </ul>
Источники света эпикопической флуоресценции	• Оптоволоконный осветитель с предварительной центровкой C-HGFI HG / C-HGFI HG (130 Вт)	
Эпикопические осветители	• P2-FIRL LED Кольцевой светодиодный осветитель	
	Используется для оптоволоконного источника света	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коаксиальный эпикопический осветитель P2-CI</li> <li>• Блок кольцевого оптоволоконного освещения P2-FIR</li> <li>• Блок оптоволоконного осветителя с двумя гибкими ручками C-FDF</li> </ul>	
Эпикопические источники света	• Светодиодный источник света для волоконного осветителя C-FLED2 LED	
Методы наблюдения	(Эпикопические) Коаксиальный эпикопический осветитель, эпифлуоресцентный осветитель, кольцевой светодиодный осветитель (Диаскопические) простая поляризация (с оборудованием для простой поляризации P2-POL) Наблюдение в темном поле (с блоком темного поля P-DF LED), наблюдение при косом освещении	
Вес (приблизительно)	32 кг (Моторизированное оборудование для эпифлуоресценции в конфигурации с тринокулярным наклоняющим тубусом, моторизованным блоком фокусировки, кодированным револьвером, основанием LED DIA и объективами 1x и 0,5x)	30 кг (Оборудование для эпифлуоресценции в конфигурации с тринокулярным наклоняющим тубусом, блоком фокусировки, кодированным револьвером, основанием LED DIA и объективами 1x и 0,5x)
Потребление электроэнергии	30 Вт (Моторизированное оборудование для эпифлуоресценции в конфигурации с тринокулярным наклоняющим тубусом, моторизованным блоком фокусировки, кодированным револьвером и основанием LED DIA)	10 Вт (Оборудование для эпифлуоресценции в конфигурации с тринокулярным наклоняющим тубусом, блоком фокусировки, кодированным револьвером, основанием LED DIA)

## Размеры

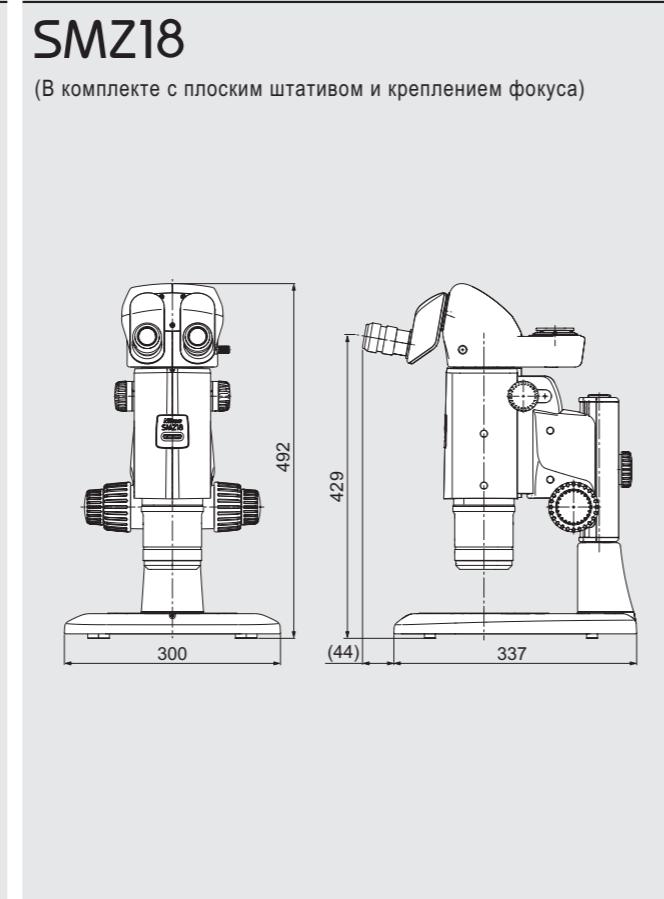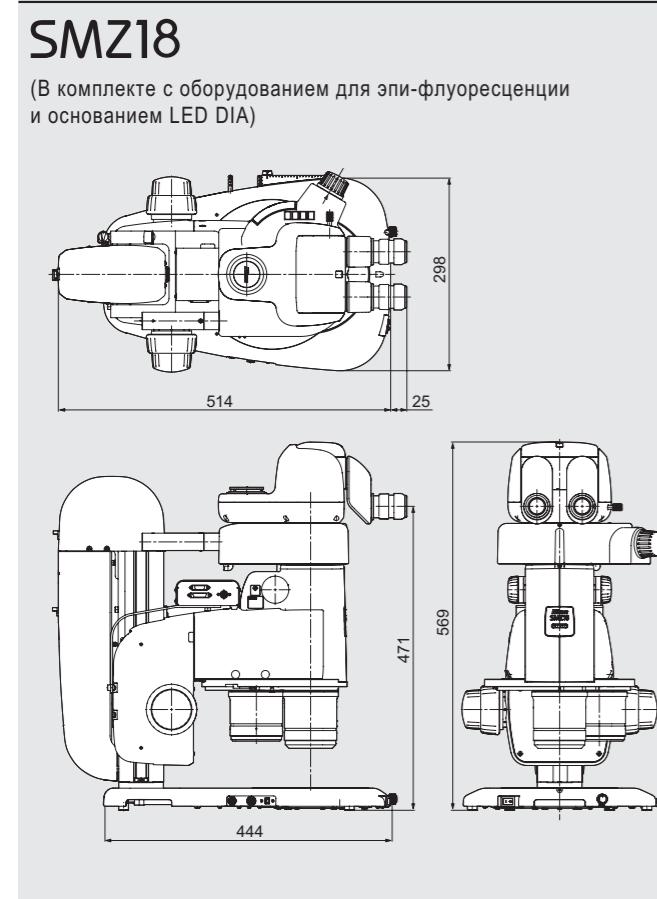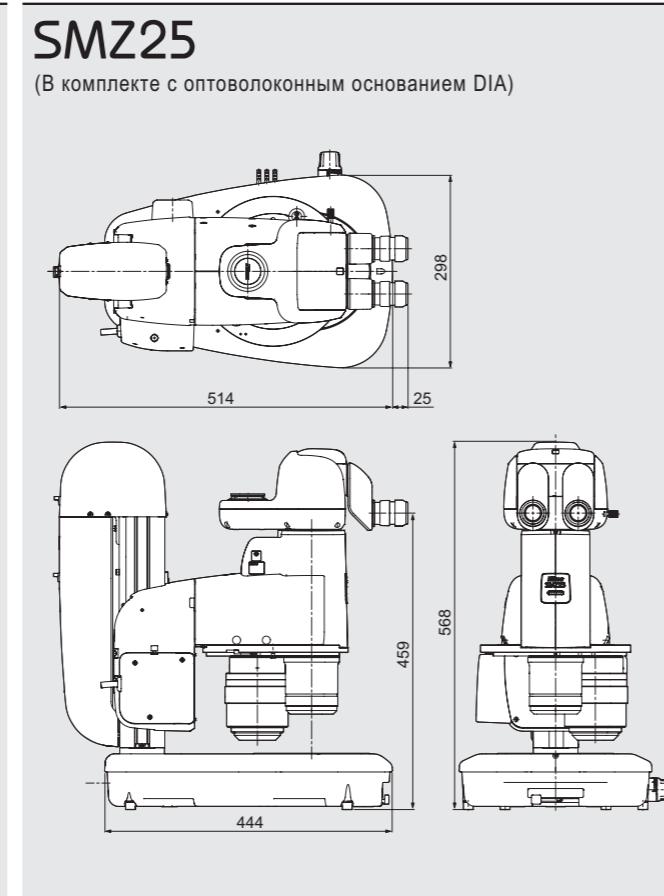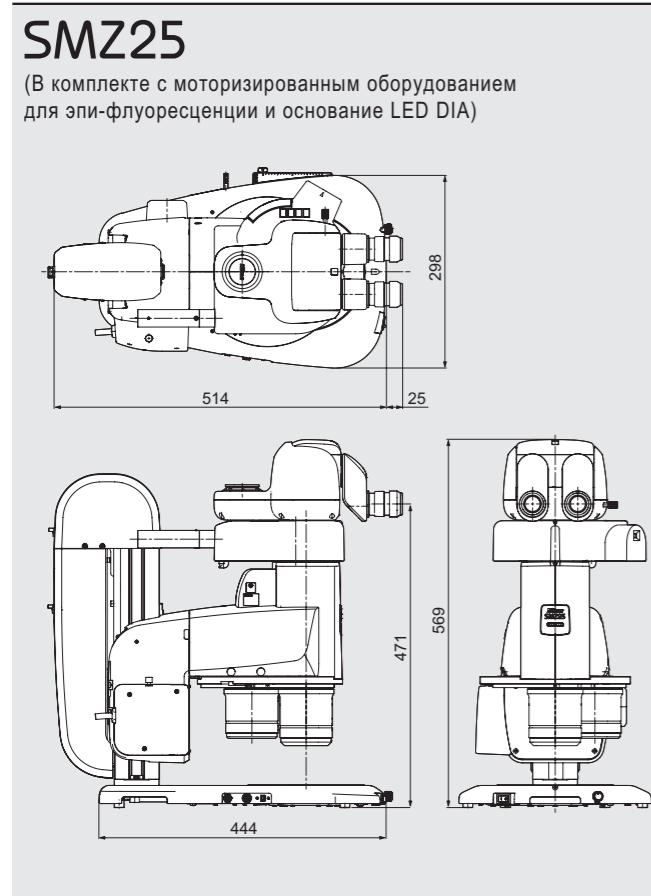

## Диаграмма системы

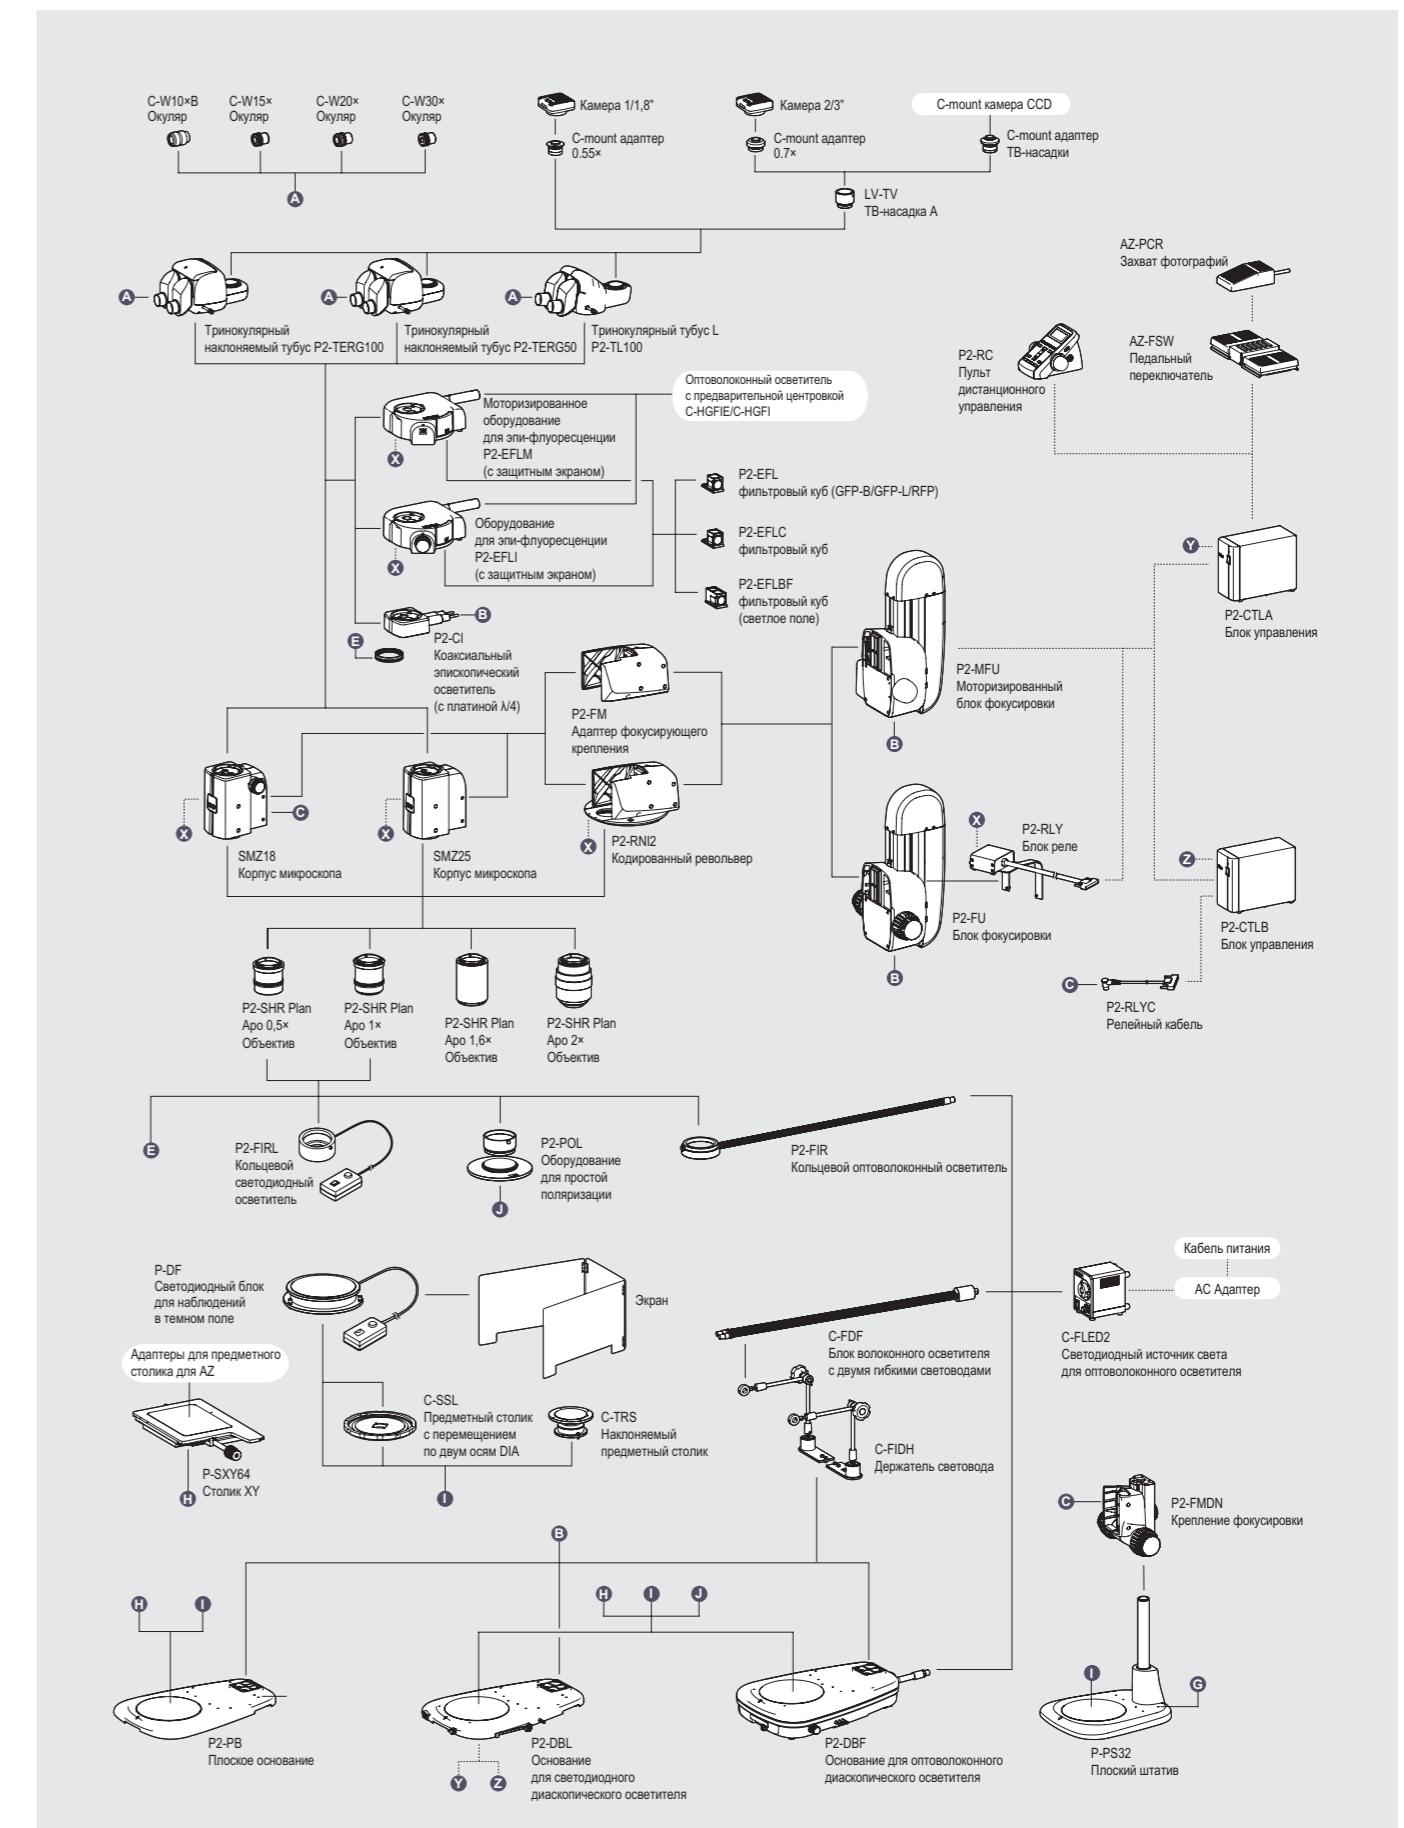

Технические характеристики и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя.

Май 2013 года ©2013 NIKON CORPORATION

Примечание: Экспорт продукции\*, представленной в этой брошюре, контролируется в соответствии с Законом «О валютном обмене и внешней торговле». Соответствующие процедуры обязательны в случае экспорта из Японии.

\*Продукция: Аппаратура и техническая информация (включая программное обеспечение).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОРПОРАЦИЯ NIKON  
Shin-Yurakucho, 12-1, Yurakucho 1-chome  
Chiyoda-ku, Токио 100-8331, Япония  
Телефон: +81-3-3216-2375 факс: +81-3-3216-2385  
<http://www.nikon.com/instruments/>



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification  
7828  
UKAS  
QUALITY  
MANAGEMENT  
008

ISO 9001 Сертифицировано для  
NIKON CORPORATION  
Компания-производитель приборов



ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification  
7825  
UKAS  
ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT  
008

ISO 14001 Сертифицировано для  
NIKON CORPORATION  
Завод в Йокогаме



**БГА**  
БиоГен-Аналитика  
ваши задачи - наши решения  
[www.bga.su](http://www.bga.su)

## ООО «БиоГен-Аналитика»

115093, Москва, Партийный пер., д.1, корп. 58, стр.1  
тел./факс: +7 499 704 62 44  
e-mail: [84997046244@bga.su](mailto:84997046244@bga.su)  
[www.bga.su](http://www.bga.su)